


Skifte av intestinalsonde

Ønskes ytterligere informasjon, kan sondesystemets veiledning leses.

Materiell


Saks, underlag, to arteriepinsetter (eller en arteriepinsett og en annen egnet pinsett), kompress, hansker og koblinger for den størrelse PEG (15 eller 20 Fr) som pasienten har.

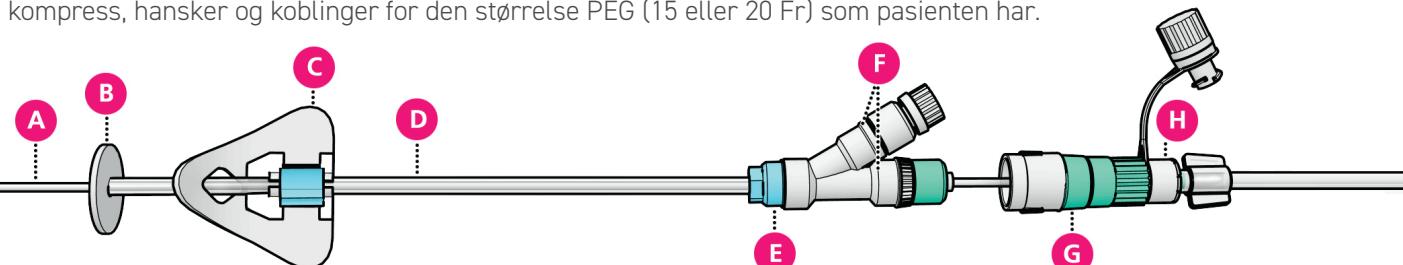

AbbVie PEG/J-sonde

- A. Intestinalsonde B. Innvendig stoppeplate C. Utvendig fikseringsplate
 D. PEG-sonde E. Blå/lilla festeskrue F. Y-stykke G. Klikk-kobling H. Luer-Lock kobling

Fjern den gamle koblingen

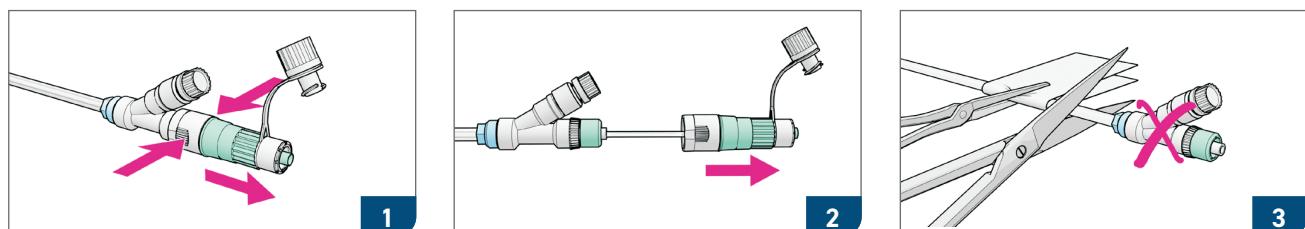


Fjern intestinalsonden ved å presse på markeringene på begge sider av klikk-koblingen og samtidig dra den ut.

Dra ut den gamle intestinalsonden.

For å unngå lekkasje, legg på et kompress og steng av PEG-en med en arteriepinsett. Gjør et rett kutt av PEG-en så nær den gamle koblingen som mulig. Kast koblingen.


Klargjør intestinalsonden

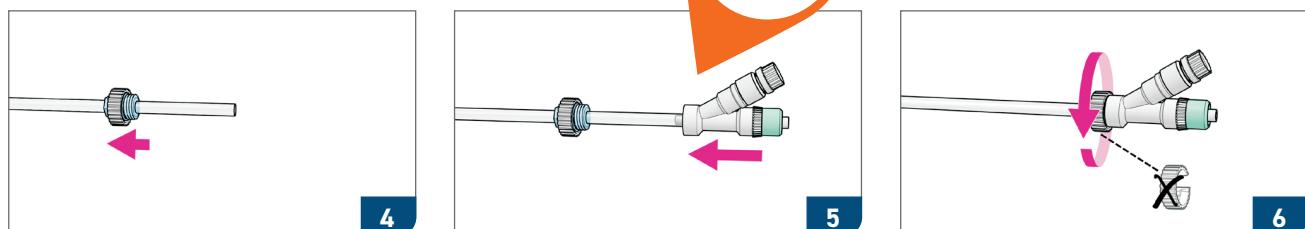


Tre den blå/lilla festeskruen på PEG-en.

Tørk godt av PEG-en. Tre Y-stykket så langt inn som mulig på PEG-en slik at den er godt festet.


Skru sammen den blå/lilla feste-skruen og Y-koblingen. Kontroller at PEG-en sitter fast i koblingen. Fjern den hvite "skrutrekkeren".

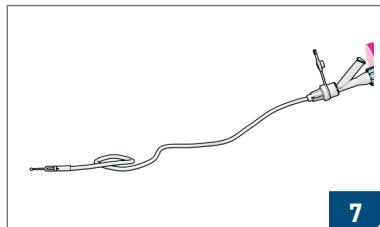


Løsne fikseringsskruen på den nye intestinalsonden.

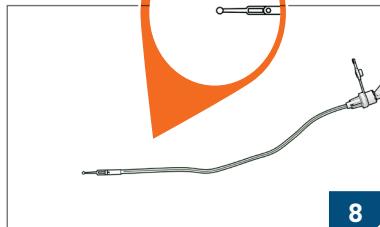


Før mandrengen helt frem til metallspissen på intestinalsonden. Vær forsiktig slik at den ikke stikker ut av sonden.

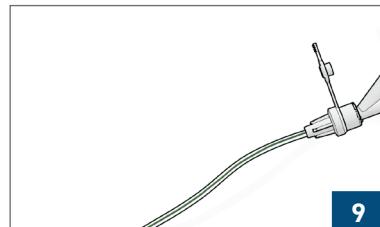


Fiksér mandrengen **godt** med fikseringsskruen.

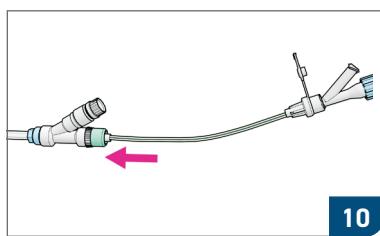

Før intestinalsondens ende inn i PEG-en og før den ned i proksimale jejunum forbi Treitzske ligament i henhold til vanlig prosedyre.

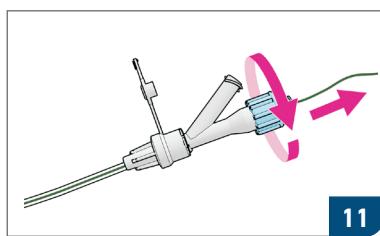


Løsne mandrengens fikseringsskrue og dra mandrengen ut av intestinalsonden.

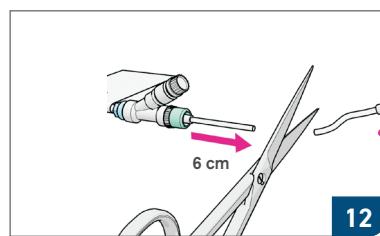


Fiksér sondene ved hjelp av en arteriepinsett. Beskytt sonden med en kompress.
Kutt intestinalsonden slik at den er ca. 6 cm.


Montering av klikk-koblingen

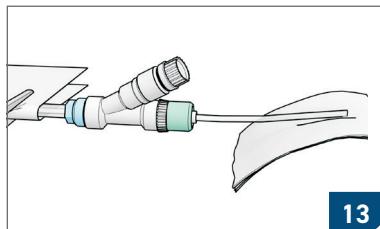


Tørk intestinalsonden godt med et kompress.

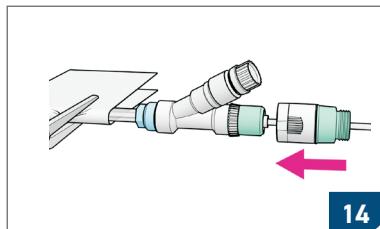


Tre den grønn/hvite klikk-koblingen på intestinalsonden. La det være et lite mellomrom mellom Y-koblingen og klikk-koblingen.

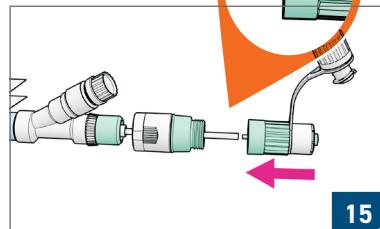


Sørg for at intestinalsonden og metallpinnen på Luer-Lock koblingen er tørre. Sørg for at intestinalsonden sitter godt og dekker hele metallpinnen før du går til neste steg.

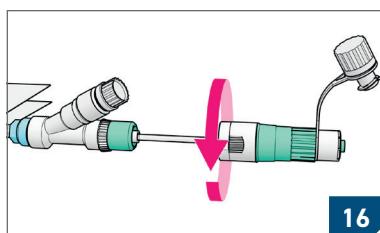

Skru klikk-koblingen fast i Luer-Lock koblingen. Skru slik at den ikke kan reverseres. Vær nøyde med å skru med klikk-koblingen slik at sonden ikke dreies.

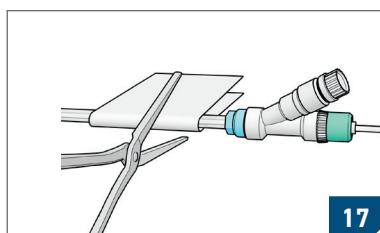

Løsne arteriepinsetten.

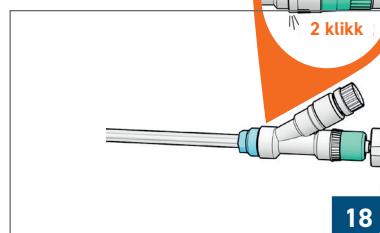

Klikk sammen Y-stykket og klikk-koblingen. **NB! 2 klikk.**
Se til at markeringene er vendt slik illustrasjonen viser. Kontroller sondeløpet ved hjelp av røntgen.